



en - ENGLISH

Sectional matrix systems

All individual components are CE marked
Medical Devices Kit for professional use only

Instructions for use

Description

All-in-one sectional matrix ring with short handles that act as forceps. There is no need for special placing tools as myClip 2.0 can be easily positioned with your fingers. myClip 2.0 features an optimal separation force that allows to create contact points in the restoration of Class II cavities.

Enden korrekt positioniert werden können, ist es wichtig, die inneren anatomischen Flügel zu erhalten. Daher sollte Sie beim Entfernen der Enden dieser Zähne am äußeren Teil festhalten.

Entfernung der Enden ②

Die Enden müssen vor jedem Reinigungs- und Sterilisationszyklus entfernt werden. Damit die Enden korrekt positioniert werden können, ist es wichtig, die inneren anatomischen Flügel zu erhalten.

Die Enden müssen vor jedem Reinigungs- und Sterilisationszyklus entfernt werden. Damit die

Enden korrekt positioniert werden können, ist es wichtig, die inneren anatomischen Flügel zu erhalten.

Daher sollten Sie beim Entfernen der Enden dieser Zähne am äußeren Teil festhalten.

Platzierung der Enden auf myClip 2.0 ③

Die Enden sind aussatuchbar und werden parweise geliefert. Die Enden lassen sich leicht abziehen; Beim Entfernen sollte mit den Fingern kein Druck auf die inneren anatomischen Flügel ausüben werden, damit diese nicht beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass die Enden so auf myClip 2.0 positioniert werden, dass sie in der Abbildung gezeigt ist. ④ KORREkte POSITIONIERUNG: Der vorgegebene Teil von myTines muss nach unten zeigen, um den Kell aufzunehmen. KREtZES AUSfENANDErNEHMEN: Entfernen Sie die myTines, indem Sie an Ihrem Hauptkörper ziehen. Ziehen Sie nicht an den Flügeln.

Composition

myClip 2.0: Stainless steel and thermoplastic | myTines: thermoplastic

LumiContrast matrices: Stainless steel | Wood wedge: Maple wood

Indications

myClip 2.0 is indicated to ensure matrix adaptation in order to create correct contact points in the restoration of class II cavities.

Contraindications

None known.

Side effects

There are no known side effects. Promptly report any serious incident by contacting your distributor or Polydentity.

Interactions with other medical devices or products

There are no known interactions.

Information for the patient

No information for the patient related to myClip 2.0 is necessary.

Shelf life

Please refer to the expiration date on the packaging. Expiration date refers to wooden wedges.

Preservation and storage

Store in a clean, dry environment away from moisture or excessive humidity.

Warnings

Due to the presence of small and sharp components, use of a rubber dam is mandatory to avoid accident ingestion or aspiration. Always use myClip 2.0 using dental floss. In case of accidental ingestion, seek medical attention. ② CORRECT POSITIONING: Select the appropriate wedge to permit creation of points of contact for the restoration of class II cavity. It is only if you let the wedge adapt to the gingival margin and insert it firmly. When needed maintain a finger on the wedge to hold it in place until it is tight enough to hold it. ③ PLACEMENT OF THE WEDGE: Expand myClip 2.0 just enough to fit around the gingival margin and insert it firmly. Once it is tight enough to hold it, release your finger, no fingers are needed. Ensure that it is tight enough to hold it. ④ KILLI POSITIONING: myClip 2.0 adapts both to teeth of different crown heights. Si la morfología de los dientes es desmable, vous pouvez utiliser myTines en association avec l'adhesive de la matrixe pour faciliter l'adaptation de la matrixe aux parois proximales et donc de réduire la nécessité des étapes de finition.

Composition

myClip 2.0: acier inoxydable et thermoplastique | myTines: thermoplastique

Matrices LumiContrast: acier inoxydable | Coin interdentaire en bois : érable.

Indications

myClip 2.0 est indiqué pour assurer l'adaptation de la matrice afin de créer les points de contact corrects lors de la restauration des cavités de classe II.

Contra-indications

Niante.

Effets secondaires

On ne connaît aucun effet secondaire connu. Priére de signaler rapidement tout incident sérieux en contactant votre distributeur ou Polydentity.

Interactions avec d'autres dispositifs ou produits médicaux

Il n'y a pas d'interactions connues.

Informations pour le patient

Il n'y a pas d'informations pour le patient.

Durée de conservation

Priére de se référer à la date de péremption figurant sur l'emballage. La date de péremption est celle des coins en bois.

Conservation et stockage

Conserver dans un environnement propre et sec, à l'abri de l'eau ou d'une humidité excessive.

Avertissement

En raison de la présence de petits éléments pointus, l'utilisation d'une gaine gingivale en caoutchouc est obligatoire afin de prévenir toute ingestion ou aspiration accidentelle. Toujours fixer myClip 2.0 à l'aide d'un fil dentaire pour éviter que la matrice ne tombe dans l'oreille ou la gorge.

Assurez-vous que toutes les extrémités sont correctement fermées et serrées.

Composition

myClip 2.0: acier inoxydable et thermoplastique | myTines: thermoplastique

Matrices LumiContrast: acier inoxydable | Coin interdentaire en bois : érable.

Indications

myClip 2.0 est indiqué pour garantir la adaptation de la matrice au fin et de créer points de contact corrects dans la restauration de cavités de classe II.

Contra-indications

None known.

Effets secondaires

On ne connaît aucun effet secondaire connu. Priére de signaler rapidement tout incident sérieux en contactant votre distributeur ou Polydentity.

Interactions avec d'autres dispositifs ou produits sanitaires

Il n'y a pas d'interactions connues.

Information pour le patient

Il n'y a pas d'informations pour le patient.

Durée de conservation

Priére de se référer à la date de péremption figurant sur l'emballage. La date de péremption est celle des coins en bois.

Conservation et stockage

Conserver dans un environnement propre et sec, à l'abri de l'eau ou d'une humidité excessive.

Avertissement

En raison de la présence de petits éléments pointus, l'utilisation d'une gaine gingivale en caoutchouc est obligatoire afin de prévenir toute ingestion ou aspiration accidentelle. Toujours fixer myClip 2.0 à l'aide d'un fil dentaire pour éviter que la matrice ne tombe dans l'oreille ou la gorge.

Assurez-vous que toutes les extrémités sont correctement fermées et serrées.

Composition

myClip 2.0: acier inoxydable et thermoplastique | myTines: thermoplastique

Matrices LumiContrast: acier inoxydable | Coin interdentaire en bois : érable.

Indications

myClip 2.0 est indiqué pour une anpassning av de kliniskt tillverkade kaviteter.

Contra-indications

None known.

Effets secondaires

On ne connaît aucun effet secondaire connu. Priére de signaler rapidement tout incident sérieux en contactant votre distributeur ou Polydentity.

Interactions avec d'autres dispositifs ou produits sanitaires

Il n'y a pas d'interactions connues.

Information pour le patient

Il n'y a pas d'informations pour le patient.

Durée de conservation

Priére de se référer à la date de péremption figurant sur l'emballage. La date de péremption est celle des coins en bois.

Conservation et stockage

Conserver dans un environnement propre et sec, à l'abri de l'eau ou d'une humidité excessive.

Avertissement

En raison de la présence de petits éléments pointus, l'utilisation d'une gaine gingivale en caoutchouc est obligatoire afin de prévenir toute ingestion ou aspiration accidentelle. Toujours fixer myClip 2.0 à l'aide d'un fil dentaire pour éviter que la matrice ne tombe dans l'oreille ou la gorge.

Assurez-vous que toutes les extrémités sont correctement fermées et serrées.

Composition

myClip 2.0: acier inoxydable et thermoplastique | myTines: thermoplastique

Matrices LumiContrast: acier inoxydable | Coin interdentaire en bois : érable.

Indications

myClip 2.0 est indiqué pour garantir l'adaptation de la matrice au fin et de créer points de contact corrects dans la restauration de cavités de classe II.

Contra-indications

None known.

Effets secondaires

On ne connaît aucun effet secondaire connu. Priére de signaler rapidement tout incident sérieux en contactant votre distributeur ou Polydentity.

Interactions avec d'autres dispositifs ou produits sanitaires

Il n'y a pas d'interactions connues.

Information pour le patient

Il n'y a pas d'informations pour le patient.

Durée de conservation

Priére de se référer à la date de péremption figurant sur l'emballage. La date de péremption est celle des coins en bois.

Conservation et stockage

Conserver dans un environnement propre et sec, à l'abri de l'eau ou d'une humidité excessive.

Avertissement

En raison de la présence de petits éléments pointus, l'utilisation d'une gaine gingivale en caoutchouc est obligatoire afin de prévenir toute ingestion ou aspiration accidentelle. Toujours fixer myClip 2.0 à l'aide d'un fil dentaire pour éviter que la matrice ne tombe dans l'oreille ou la gorge.

Assurez-vous que toutes les extrémités sont correctement fermées et serrées.

Composition

myClip 2.0: acier inoxydable et thermoplastique | myTines: thermoplastique

Matrices LumiContrast: acier inoxydable | Coin interdentaire en bois : érable.

Indications

myClip 2.0 est indiqué pour garantir l'adaptation de la matrice au fin et de créer points de contact corrects dans la restauration de cavités de classe II.

Contra-indications

None known.

Effets secondaires

On ne connaît aucun effet secondaire connu. Priére de signaler rapidement tout incident sérieux en contactant votre distributeur ou Polydentity.

Interactions avec d'autres dispositifs ou produits sanitaires

Il n'y a pas d'interactions connues.

Information pour le patient

Il n'y a pas d'informations pour le patient.

Durée de conservation

Priére de se référer à la date de péremption figurant sur l'emballage. La date de péremption est celle des coins en bois.

Conservation et stockage

Conserver dans un environnement propre et sec, à l'abri de l'eau ou d'une humidité excessive.

Avertissement

En raison de la présence de petits éléments pointus, l'utilisation d'une gaine gingivale en caoutchouc est obligatoire afin de prévenir toute ingestion ou aspiration accidentelle. Toujours fixer myClip 2.0 à l'aide d'un fil dentaire pour éviter que la matrice ne tombe dans l'oreille ou la gorge.

Assurez-vous que toutes les extrémités sont correctement fermées et serrées.

Composition

myClip 2.0: acier inoxydable et thermoplastique | myTines: thermoplastique

Matrices LumiContrast: acier inoxydable | Coin interdentaire en bois : érable.

Indications

myClip 2.0 est indiqué pour garantir l'adaptation de la matrice au fin et de créer points de contact corrects dans la restauration de cavités de classe II.

Contra-indications

None known.

Effets secondaires

On ne connaît aucun effet secondaire connu. Priére de signaler rapidement tout incident sérieux en contactant votre distributeur ou Polydentity.

Interactions avec d'autres dispositifs ou produits sanitaires

Il n'y a pas d'interactions connues.

Information pour le patient

Il n'y a pas d'informations pour le patient.


Durée de conservation

Priére de se référer à la date de péremption figurant sur l'emballage. La date de péremption est celle des coins en bois.

Conservation et stockage

sectional
matrix
systems


Application

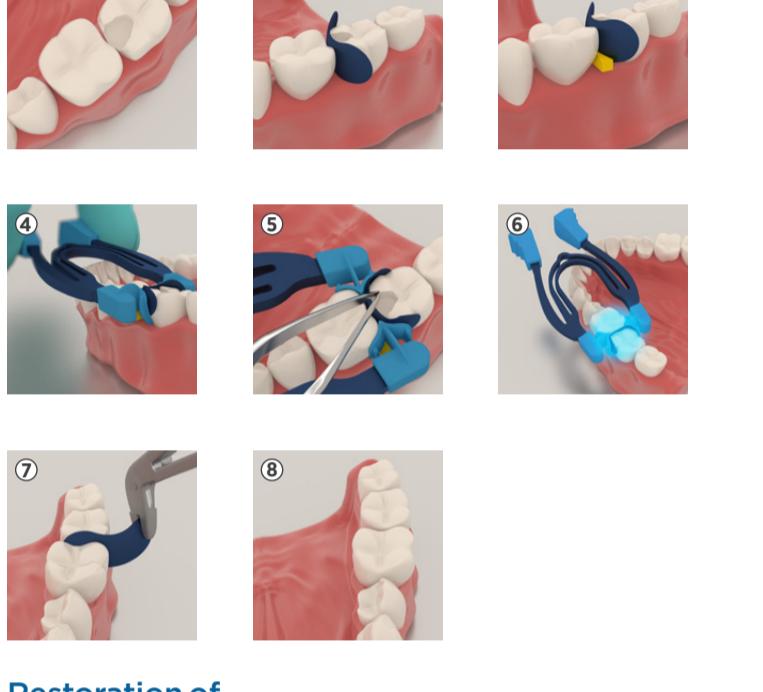

Restoration of adjacent cavities



Tines removal

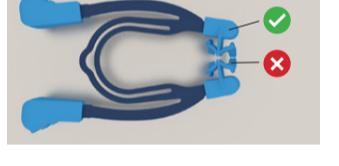

Tines placement on myClip 2.0

